



# NASAの技術を実感する空気洗浄機

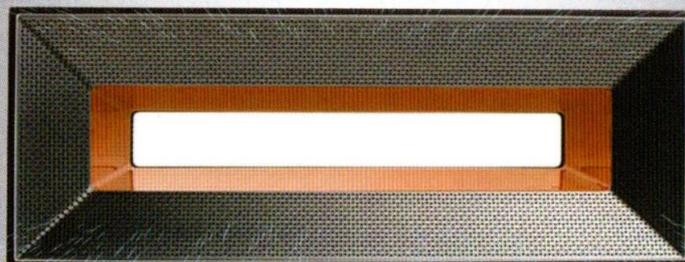

米国ではFDA<sup>※</sup>の基準により医療機器認定を受けており、米国国内の医療施設での使用が正式に認可されています。

FDA 認可番号 3002959861

※FDA=アメリカ食品医薬品局  
※写真はイメージです

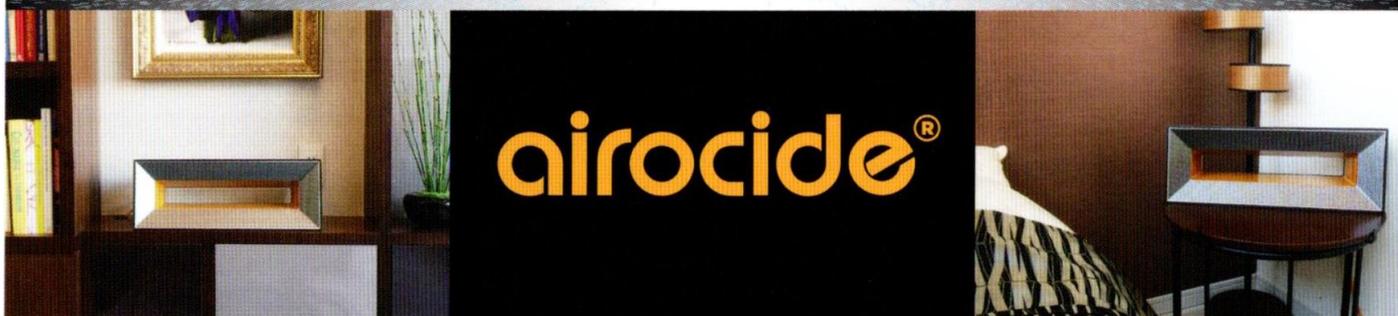

## NASA

### NASAのPCO<sup>※1</sup>技術を使用！



AIROCIDE APS-200 リアクションチャンバー

光触媒により、有機物を水とCO<sub>2</sub>に分解します。

### AIROCIDE テクノロジー

AIROCIDE は空気中に浮遊するウィルスやバクテリア、ニオイなどを吸い込み、内部に搭載したPCO<sup>※1</sup>技術により空気の洗浄を行います。

本機は、運転し続けることで空気洗浄サイクルを構築して徐々に空気洗浄します。

電源はなるべくONにしたままお使いください。長期ご不在時やリアクションチャンバーの交換時は必ず電源OFFにしてください。

AIROCIDE はFDA<sup>※2</sup>の認可商品です。

認可番号 3002959861

本製品は、FDA<sup>※2</sup>の医療機器認定を受けており、米国国内の医療施設での使用が正式に認可されています。

## NASA to Now

NASA は、密閉された宇宙ステーションやスペースシャトル内の空気環境を改善するための技術が必要としており、スペースシャトルへこの技術を導入しました。その後も研究は続けられ、現在はアメリカ国内のクリニック・病院・救急治療室・歯科医院などでも導入されています。

この技術を、より発展させご家庭向けに改良したものがAIROCIDEです。これにより、ご自宅でもお気軽にNASAの空気洗浄技術を実感いただけるようになりました。

(感じ方には個人差があります)



お問合せ先；WIN・TEC 株式会社

〒658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町4丁目14-30

TEL 078-762-3150 E-mail; info@wintec.biz

※1 光触媒技術 ※2 FDA=アメリカ食品医薬品局

# パーソナル空気清浄機

airgle  
Precisely Pure

## NASAのPCO<sup>\*</sup>技術を改善したAG25

※光触媒によりウイルス・バクテリアを水とCO<sub>2</sub>に分解する技術



車の中の空気もきれいに



ペットの臭いもきれいに



居間の、細菌・花粉もきれいに

FDA (アメリカ食品医薬品局) の認可商品です。  
メーカーFDA認可番号 3015139810

NASAのPCO<sup>\*1</sup>技術を改善した  
**airgle AG25**




## パーソナル空気清浄機

専用設計のチタンプロUVモジュールで微細な汚染物質を除去します。

ウイルス  
細菌  
ニオイ  
花粉

c-HEPA  
チタンプロUVモジュール  
活性炭フィルター

清潔な空気

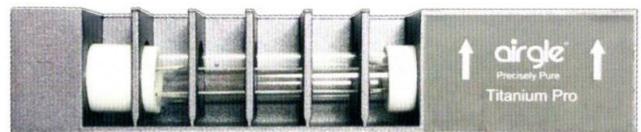

## NASAが使用した科学技術を改善

●空間を浮遊する多くの汚染物質（バクテリア・ウイルス・カビなどのアレルゲン、さらにタバコの煙・ニオイ・ガスなど）をチタンプロUVモジュールと2種類のフィルターで99%<sup>\*2</sup>以上除去。ウイルスなどは水や二酸化炭素に分解し不活性化します。

●FDA (アメリカ食品医薬品局) により、アメリカ国内の医療施設での使用が正式に認可された製品です。



お問合せ先; WIN・TEC 株式会社  
〒658-0003 兵庫県神戸市東灘区本山北町4丁目14-30  
TEL 078-762-3150 E-mail; info@wintec.biz

※1 光触媒により、ウイルス・バクテリアを水とCO<sub>2</sub>に分解する技術

※2 メーカー調べ GUANG ZHOU INSTITUTE OF MICROBIOLOGY No. KJ20181964 / CHINA NATIONAL ANALYTICAL CENTER No. 2018011114-1-3aER1 / No. 2018011114-1-2bER1